

สถานพยาบาลที่มีห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง



Monoplace 4 (พริ. 1)

Multiplace 2 (พริ. 1)

Monoplace 2 (พริ. 1)

Multiplace 1 (พริ. 1)

Monoplace 1

Multiplace 1


Monoplace 1

Multiplace 1

TYPICAL HBO WOUND PROTOCOL

Descent Rate = 15 Ft./Min.

Ascent Rate = 15 Ft./Min.

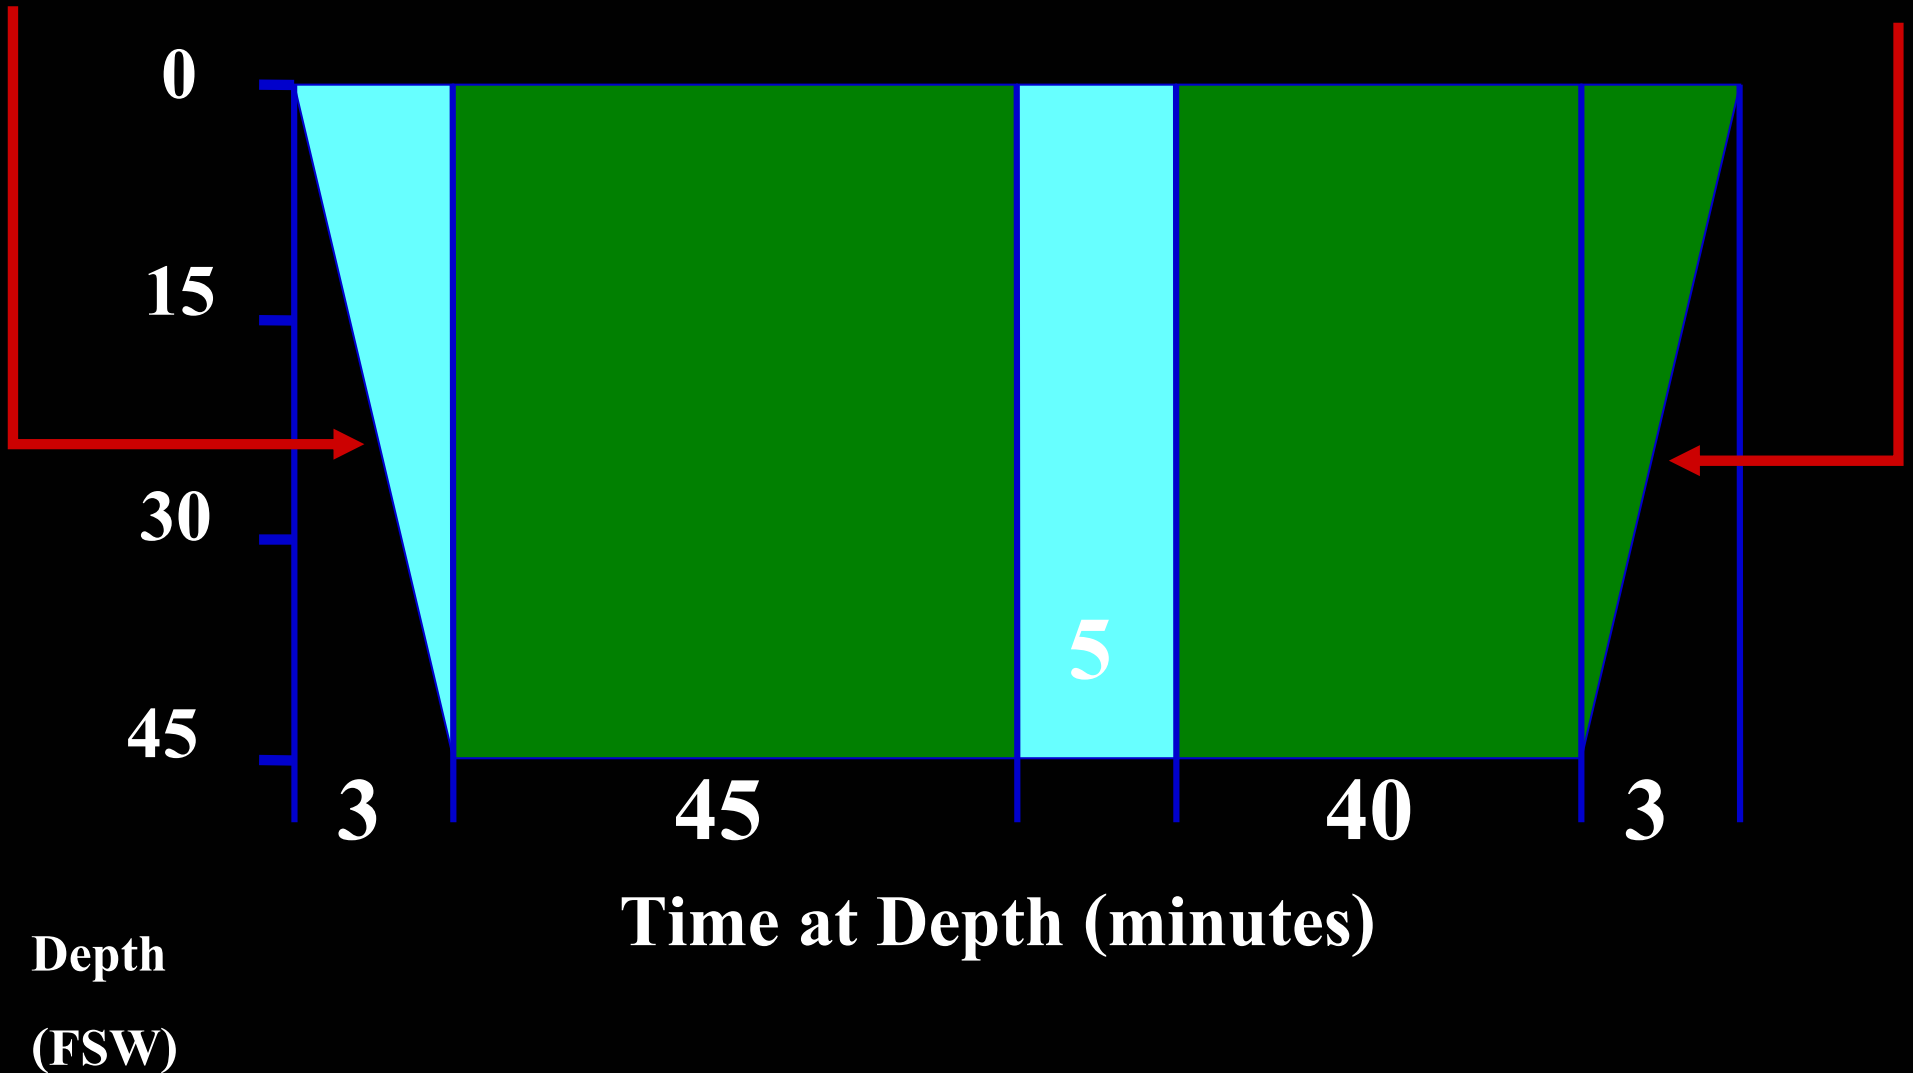

Mechanisms of HBO



- Hyperbaric + Oxygen
 - Pressure Effect
 - Hyperoxia (Elevated PO_2)